


MTC 12K
TERMOČLÁNKY KABELOVÉ S KABELOVÝM OKEM

standardní provedení:

termočlánekové vedení typ GHGHV, třída přesnosti 2 dle ČSN EN 60584 (DIN 43710)
izolace 2x speciální skelné vlákno, nerezový oplet / průřez vodičů: 2x 0,22mm² lanko;
maximální pracovní teplota +600°C
materiál připojovacího dílu: **B,C** - nerezová ocel třídy 17, **A,D** - mosaz

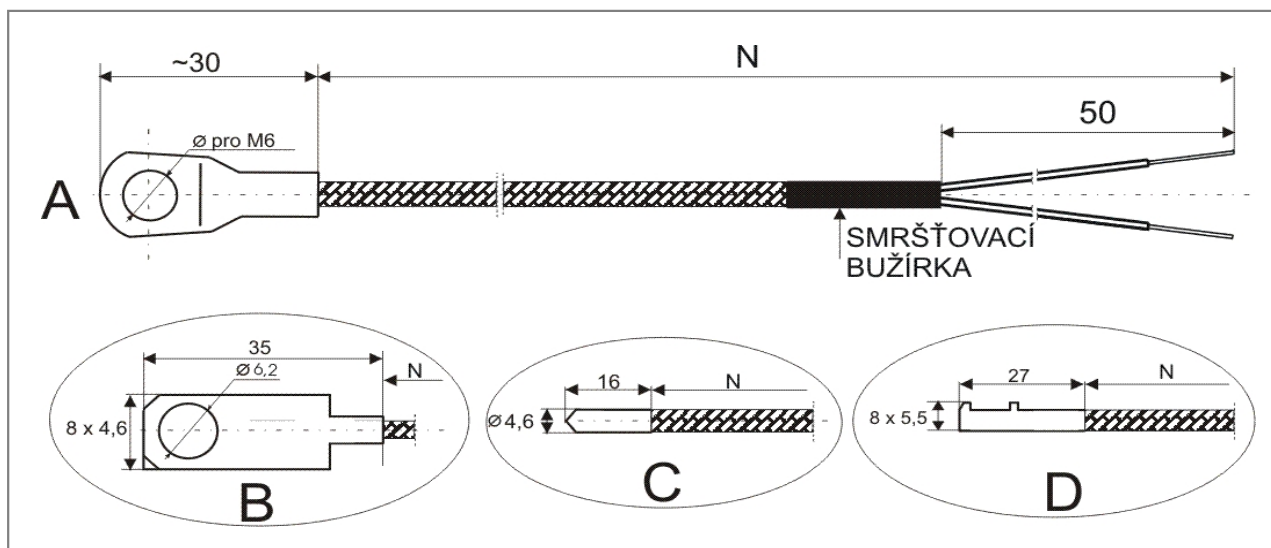

Objednací kód:

MTC 12 K -				
Vedení GHGHV, typ termoclanku "K"	0			
Vedení GHGHV, typ termoclanku "J"	1			
Vedení GHGHV, typ termoclanku "L"	2			
Provedení kabelového oka				
Provedení A (viz nákras, určeno na utažení pod šroub)	0			
Provedení B (viz nákras, určeno na utažení pod šroub. Robustní provedení)	1			
Provedení C (viz nákras, jen s nerezovou špičkou)	2			
Provedení D (viz nákras, určeno na utažení pod stahovací pásku - např. k potrubí)	3			
Délka termoclanku N [cm] (10 - 10000 cm)				
zadejte délku termoclanku		XXXX		
Provedení studeného konce termoclanku				
volné konce				0
konektor standardní velikosti (MTCK-SM-X, zástrčka)				1
konektor standardní velikosti (MTCK-S...) včetně protikusu a příslušenství				2
miniaturní konektor (MTCK-MM-X, zástrčka)				3
miniaturní konektor (MTCK-M...) včetně protikusu a příslušenství				4
standardní keramický konektor (MTCK-CSM-X, zástrčka)				5
standardní keramický konektor (včetně protikusu a příslušenství)				6

Příklad objednacího kódu: MTC12K-01-400-1

2014-02-TC12K

MTC 12K**TERMOČLÁNKY KABELOVÉ S KABELOVÝM OKEM**

*Kratší (expresní) dodací lhůta je možná s příplatkem k základní ceně.
Na vyžádání je řešena individuální kalkulací.
Pro účely výpočtu ceny se délka vedení (čili snímače)
zaokrouhluje na desetiny metru nahoru.*

Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12K	2014-02-DTC12K
konektory	2014-02-MK, 2014-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2014-02-KS

2014-02-TC12K